

2019年12月吉日



得意先様各位

「CT用エクステンションチューブ／エクステンションチューブ」  
オスロックコネクタ形状変更のご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
このたび弊社製品「CT用エクステンションチューブ」および「エクステンションチューブ」の  
下記対象製品におきまして、オスロックコネクタの操作性向上を目的とした形状変更をすること  
となりましたので、ご案内申し上げます。  
今後とも、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


敬具

記

対象製品： 販売名／エクステンションチューブ  
製品名／CT用エクステンションチューブ  
エクステンションチューブ

対象型式： 下記一覧参照

変更内容： オスロックコネクタの形状変更（下図参照）

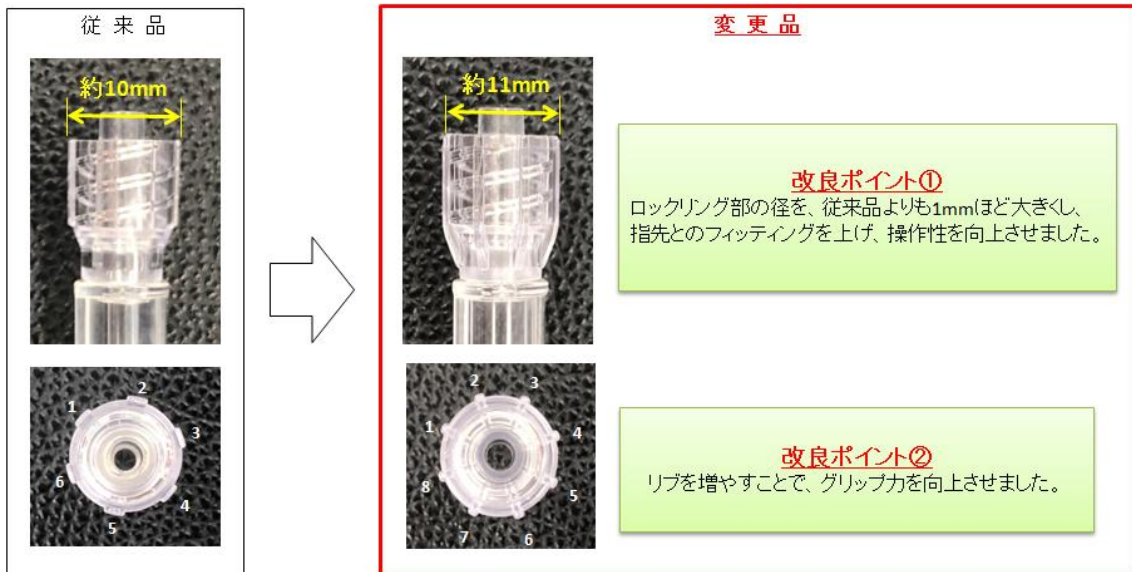

○変更品の製造番号と出荷予定時期（2019年12月時点）

製品名	型式（品番）	製造番号	出荷予定時期
CT用エクステンションチューブ	FGM-CTX-80-1B	191118	2020年1月以降
CT用エクステンションチューブ	FGM-CTX-250-1B	未定	未定
CT用エクステンションチューブ	FGM-CTX-600-1B	191118	2020年1月以降
CT用エクステンションチューブ	FGM-CTX-1000-1B	191108	2020年2月以降
CT用エクステンションチューブ	FGM-CTX-1300-1B	191204	変更品出荷済
CT用エクステンションチューブ	FGM-CTX-1500-1B	191204	変更品出荷済
CT用エクステンションチューブ	FGM-CTX2-600-1B	未定	未定
CT用エクステンションチューブ	FGM-CTX2-1000-1B	191209	2020年2月以降
CT用エクステンションチューブ	FGM-CTX2-1500-1B	未定	未定
エクステンションチューブ	FGM-CT-600	未定	未定
エクステンションチューブ	FGM-CT-1000	191127	2020年2月以降
エクステンションチューブ	FGM-CTY-600	未定	未定
エクステンションチューブ	FGM-CTY-1000	未定	未定
エクステンションチューブ	FGM-CTY-1500	未定	未定
エクステンションチューブ	FGM-CTY-2000	未定	未定
エクステンションチューブ	FGM-CTY-1500R	未定	未定
エクステンションチューブ	FGM-CTY-2000R	191118	2020年2月以降
エクステンションチューブ	FGM-CTY2-1000	未定	未定

※この変更による製品の操作方法、取り扱い方に変更はございません。

本件に関するお問い合わせ先： フォルテ グロウ メディカル株式会社 東京営業所  
 東京都千代田区神田佐久間河岸 51 第一スレートビル 5F  
 TEL:03-3863-1901 FAX:03-3863-1905

以上